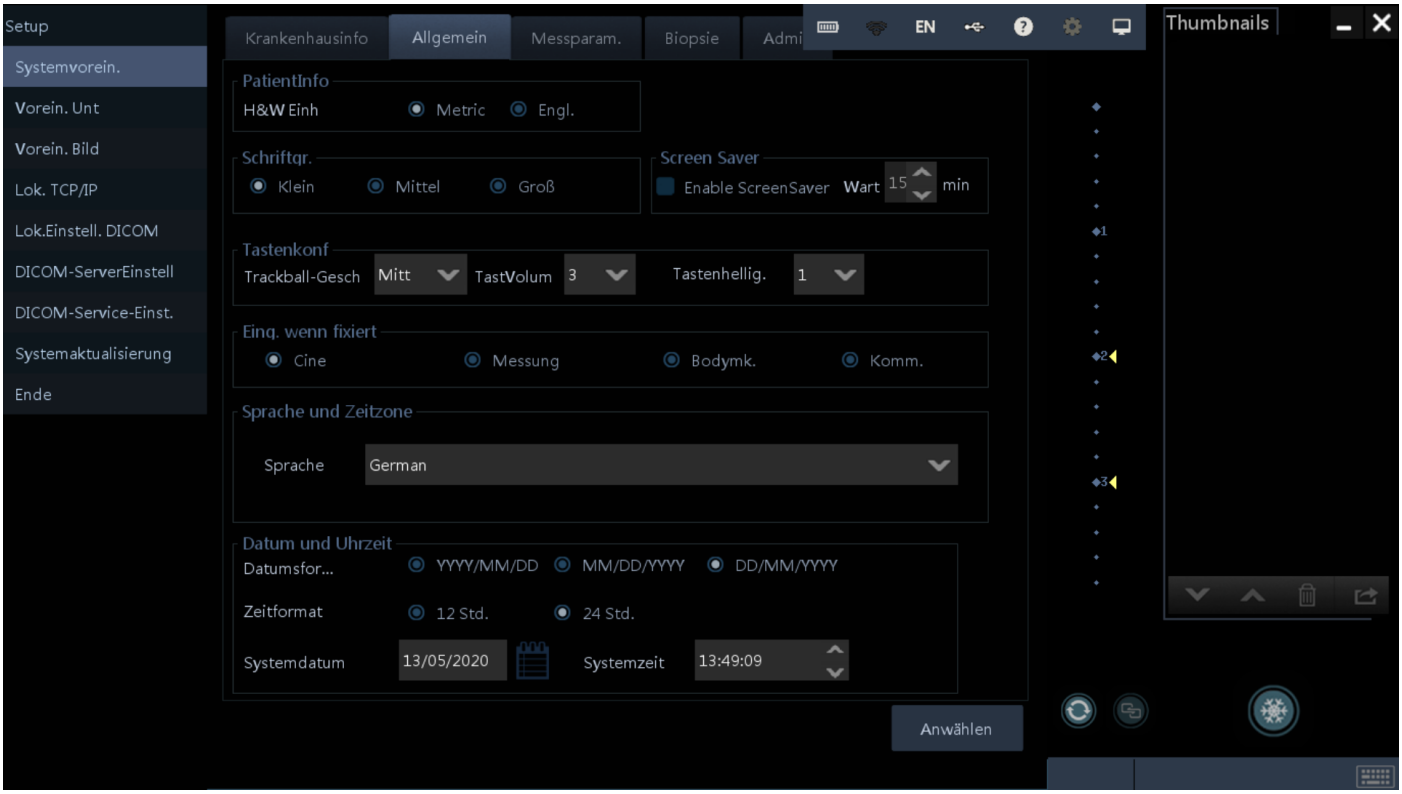
Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
Krankenhausinfo
Allgemein
Messparam.
Biopsie
Admi
EN
Thumbnails
PatientInfo
H&W Einh
Metric
Engl.
Schriftgr.
Klein
Mittel
Groß
Screen Saver
Enable ScreenSaver
Wart
15
min
Tastenkonf
Trackball-Gesch
Mitt
TastVolum
3
Tastenhellig.
1
Einq. wenn fixiert
Cine
Messung
Bodymk.
Komm.
Sprache und Zeitzone
Sprache
German
Datum und Uhrzeit
Datumsfor...
YYYY/MM/DD
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
Zeitformat
12 Std.
24 Std.
Systemdatum
13/05/2020
Systemzeit
13:49:09
Anwählen

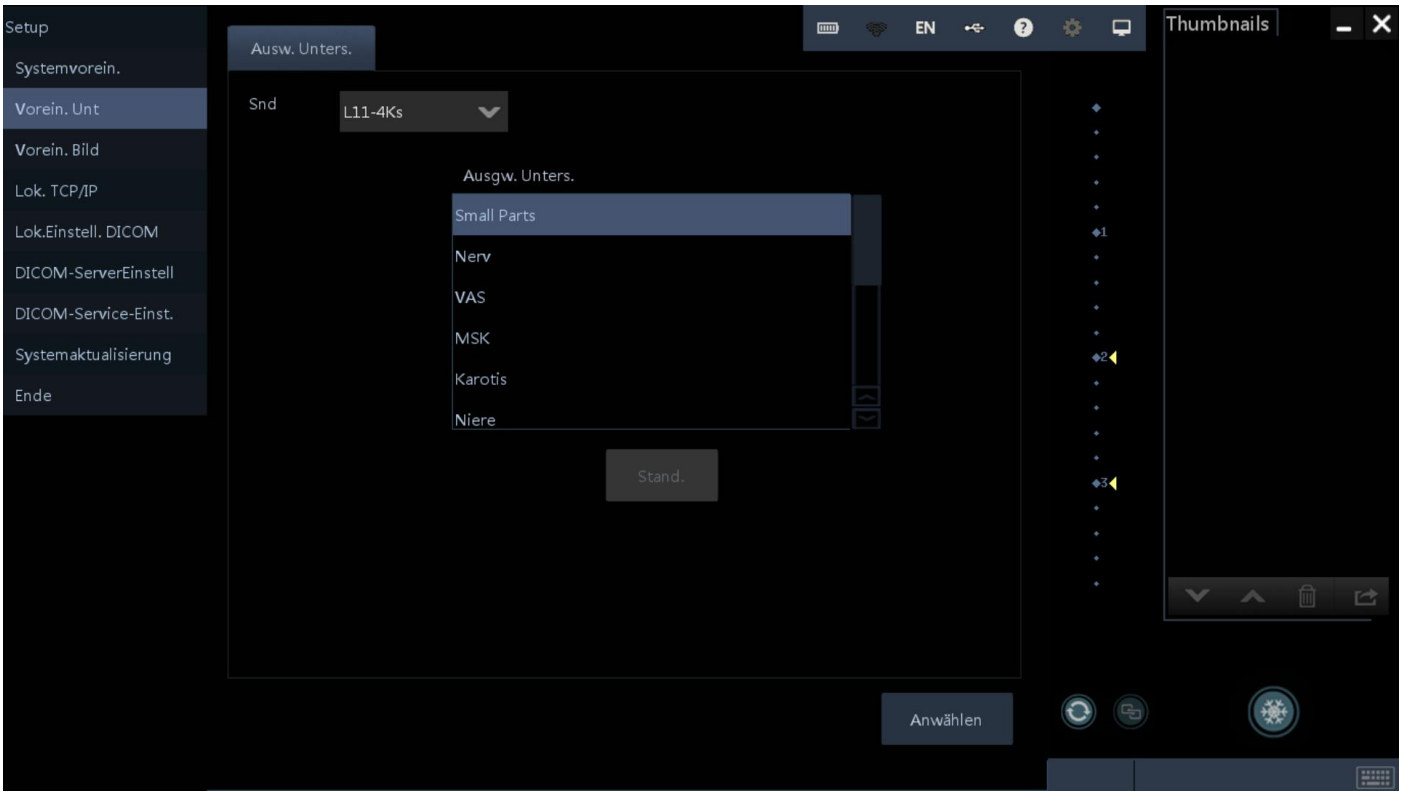
Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
Ausw. Unters.
EN
Thumbnails
Snd
L11-4Ks
Ausgw. Unters.
Small Parts
Nerv
VAS
MSK
Karotis
Niere
Stand.
Anwählen

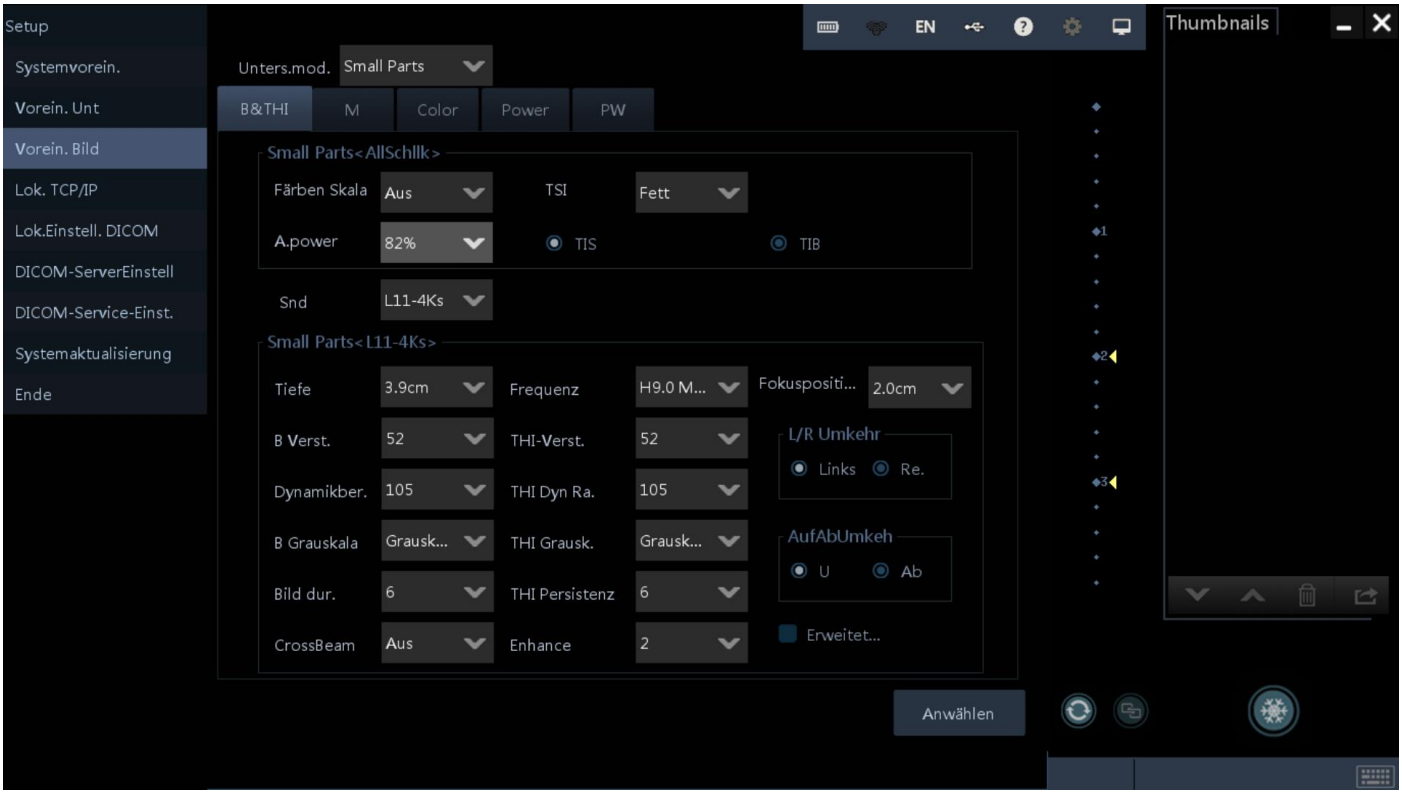
Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
EN
Thumbnails
Unters.mod. Small Parts
B&THI
M
Color
Power
PW
Small Parts<AllSchlk>
Färben Skala Aus
TSI Fett
A.power 82%
TIS
TIB
Snd L11-4Ks
Small Parts<L11-4Ks>
Tiefe 3.9cm
Frequenz H9.0 M...
Fokuspositi... 2.0cm
B Verst. 52
THI-Verst. 52
L/R Umkehr
Links
Re.
Dynamikber. 105
THI Dyn Ra. 105
B Grauskala Grausk...
THI Grausk. Grausk...
AufAbUmkeh
U
Ab
Bild dur. 6
THI Persistenz 6
CrossBeam Aus
Enhance 2
Erweitet...
Anwählen

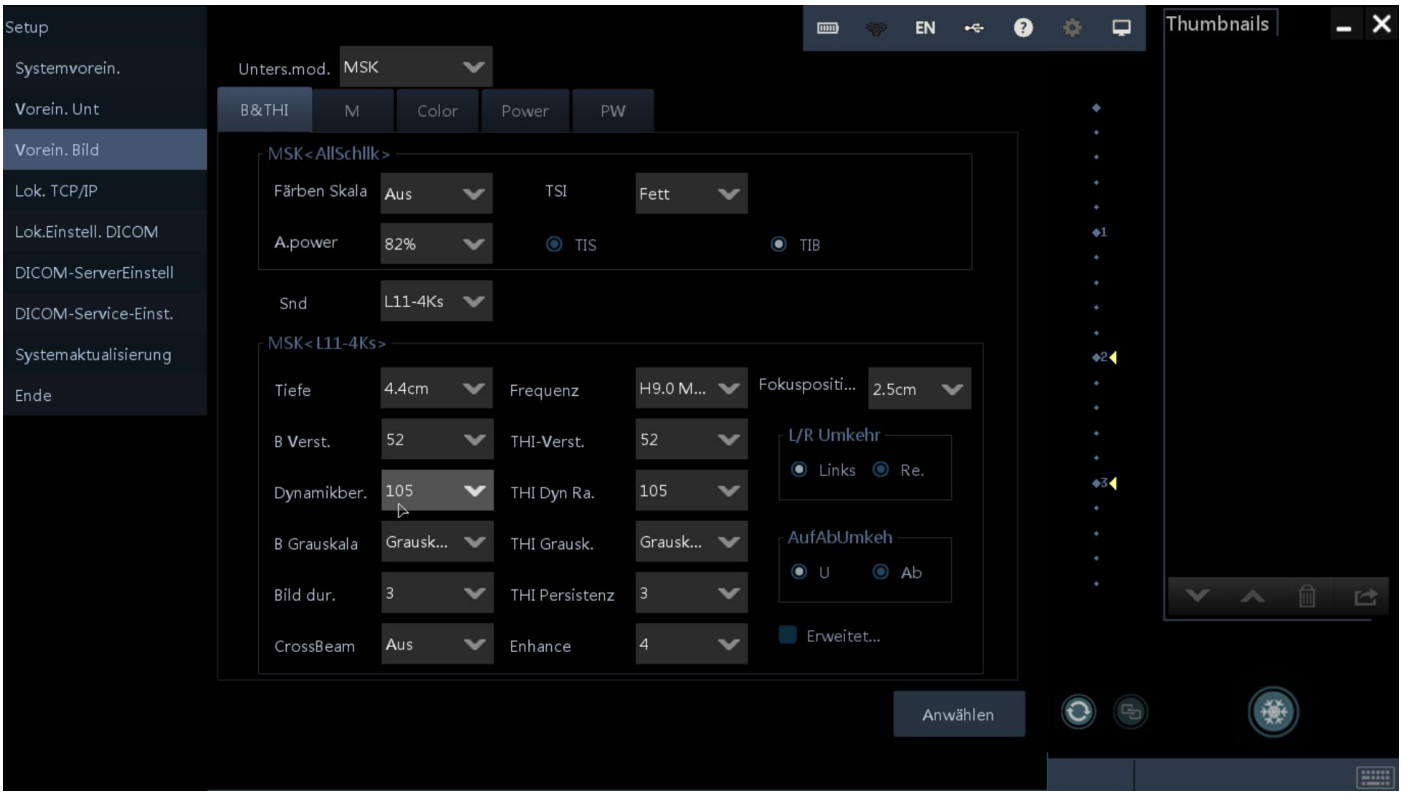
Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
EN
Thumbnails
Unters.mod. MSK
B&THI
M
Color
Power
PW
MSK<AllSchlk>
Färben Skala Aus
TSI Fett
A.power 82%
TIS
TIB
Snd L11-4Ks
MSK<L11-4Ks>
Tiefe 4.4cm
Frequenz H9.0 M...
Fokuspositi... 2.5cm
B Verst. 52
THI-Verst. 52
L/R Umkehr
Links
Re.
Dynamikber. 105
THI Dyn Ra. 105
B Grauskala Grausk...
THI Grausk. Grausk...
AufAbUmkeh
U
Ab
Bild dur. 3
THI Persistenz 3
CrossBeam Aus
Enhance 4
Erweitet...
Anwählen

L11-4Ks Small ... 13/05/2020 13:51:21
EN
Thumbnails
[B]
Frequenz H9.0 MHz
DR 105
Verstärk. 52
Bildrate 16
Tiefe 3.9
AP 82%
MI 0.2 TIS 0.1
Funktion
Bild-Modus
B
Verstärk. 52
Tiefe 3
Frequ... H9.0 ...
Dynamikber. 105
Fokusposition
Grauska. 3

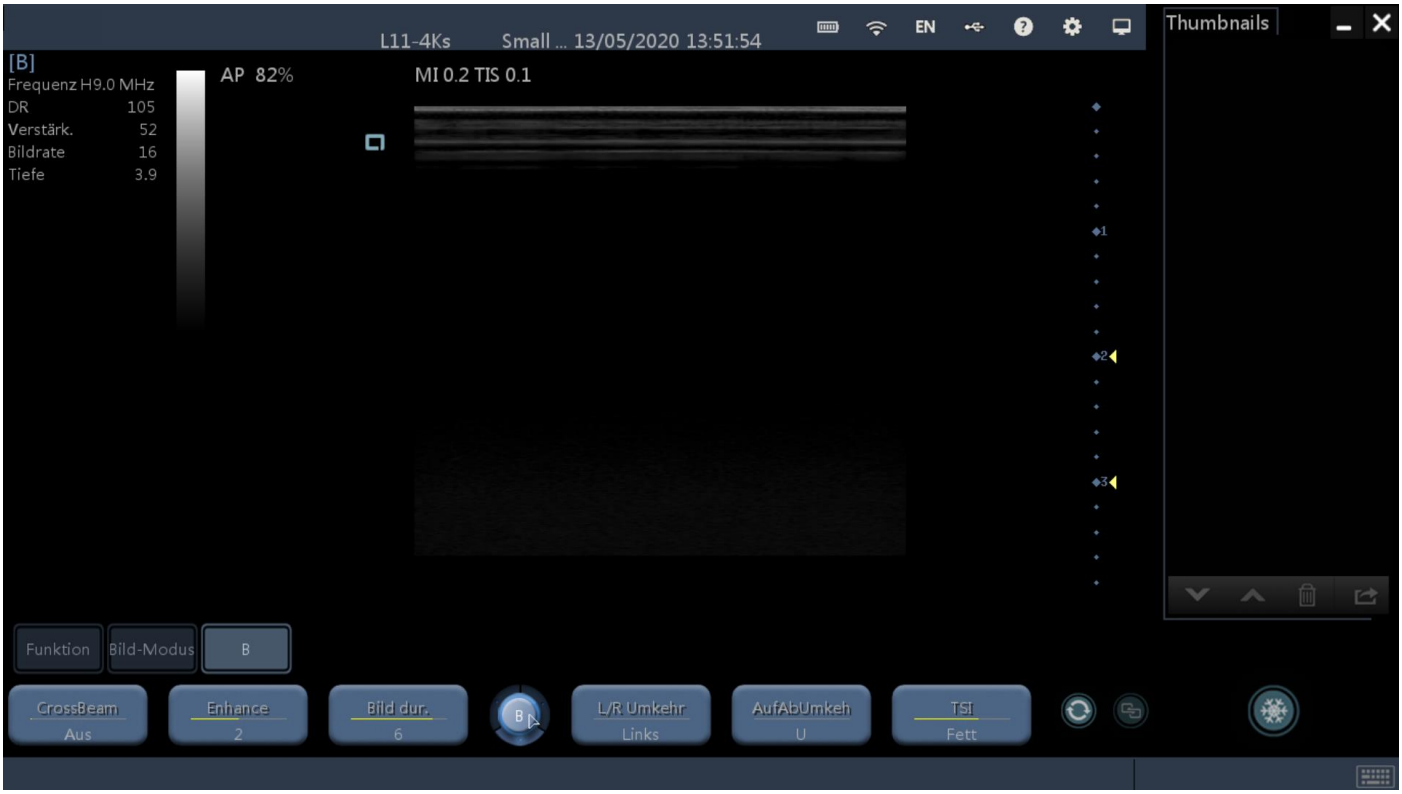
L11-4Ks Small ... 13/05/2020 13:51:54
EN
Thumbnails
[B]
Frequenz H9.0 MHz
DR 105
Verstärk. 52
Bildrate 16
Tiefe 3.9
AP 82%
MI 0.2 TIS 0.1
Funktion
Bild-Modus
B
CrossBeam Aus
Enhance 2
Bild dur. 6
L/R Umkehr Links
AufAbUmkeh U
TSI Fett

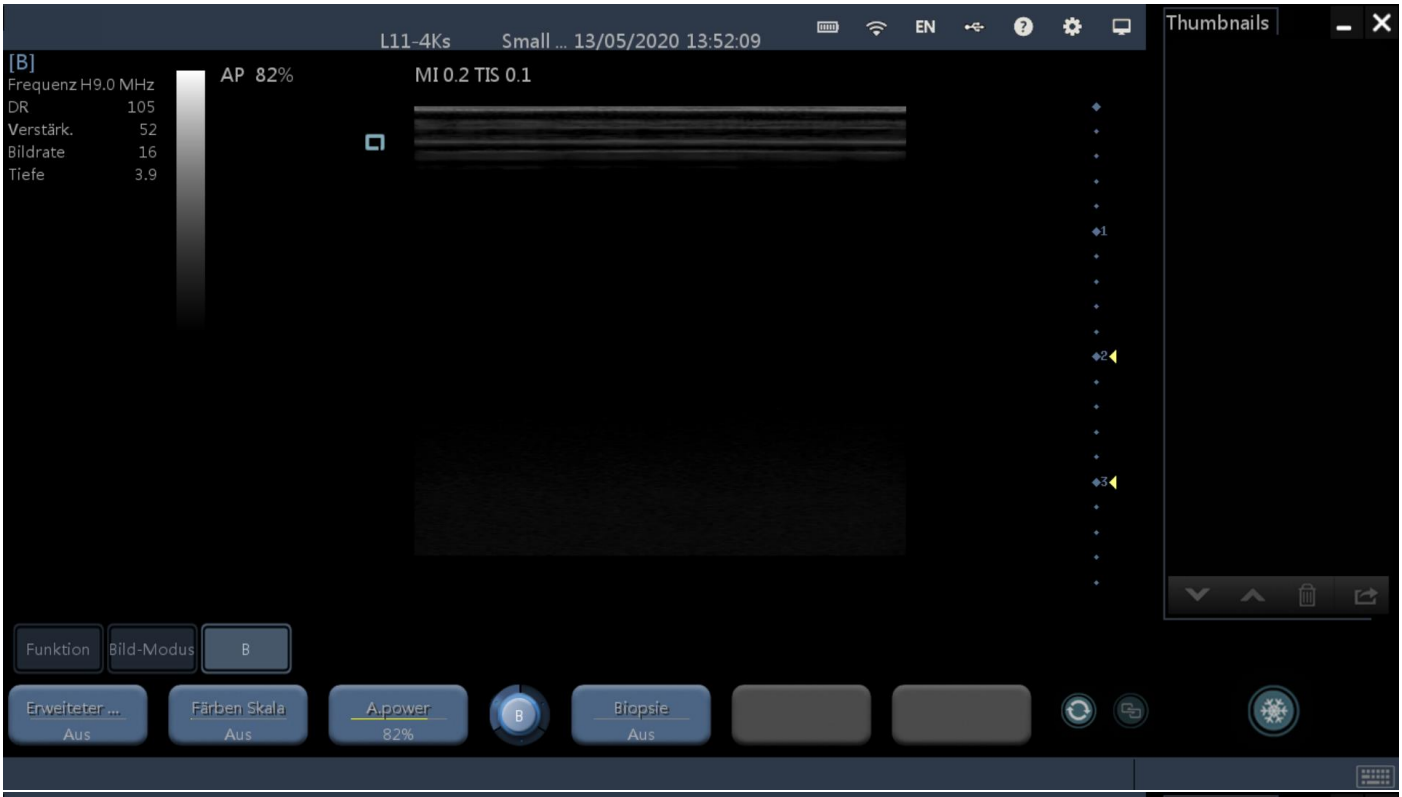
L11-4Ks
Small ... 13/05/2020 13:52:09
EN
Thumbnails
[B]
Frequenz H9.0 MHz
DR 105
Verstärk. 52
Bildrate 16
Tiefe 3.9
AP 82%
MI 0.2 TIS 0.1
Funktion
Bild-Modus
B
Erweiteter ...
Aus
Färben Skala
Aus
A.power
82%
Biopsie
Aus

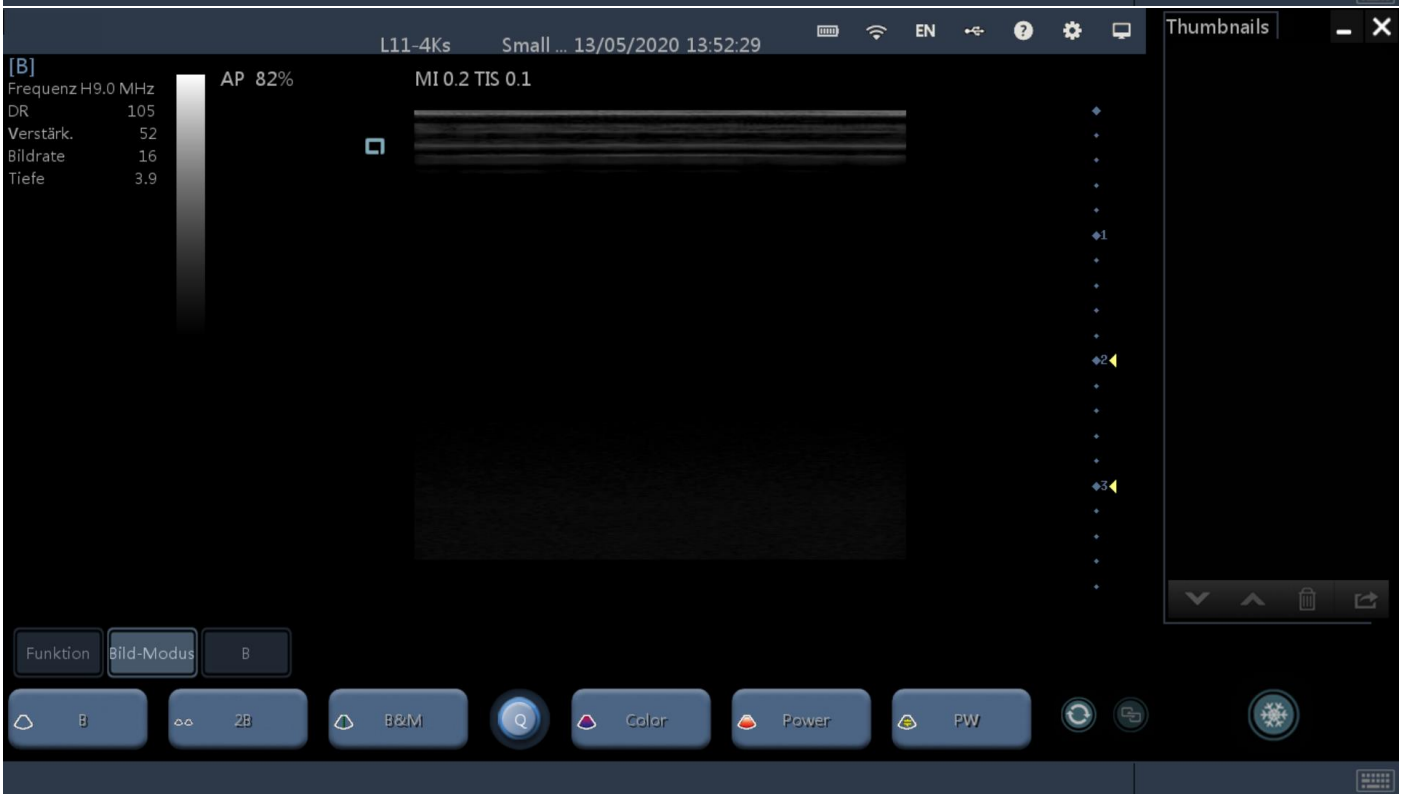
L11-4Ks
Small ... 13/05/2020 13:52:29
EN
Thumbnails
[B]
Frequenz H9.0 MHz
DR 105
Verstärk. 52
Bildrate 16
Tiefe 3.9
AP 82%
MI 0.2 TIS 0.1
Funktion
Bild-Modus
B
B
2B
B&M
Color
Power
PW

L11-4Ks
Small ... 13/05/2020 13:53:09
EN
Thumbnails
[B2]
Frequenz H9.0 MHz
DR 105
Verstärk. 52
Bildrate 16
Tiefe 3.9
AP 82%
MI 0.2 TIS 0.1
Funktion
Bild-Modus
B
2B
Verstärk. 52
Tiefe 3
Frequ... H9.0 ...
B
Dynamikber. 105
Fokusposition
Grauska. 3

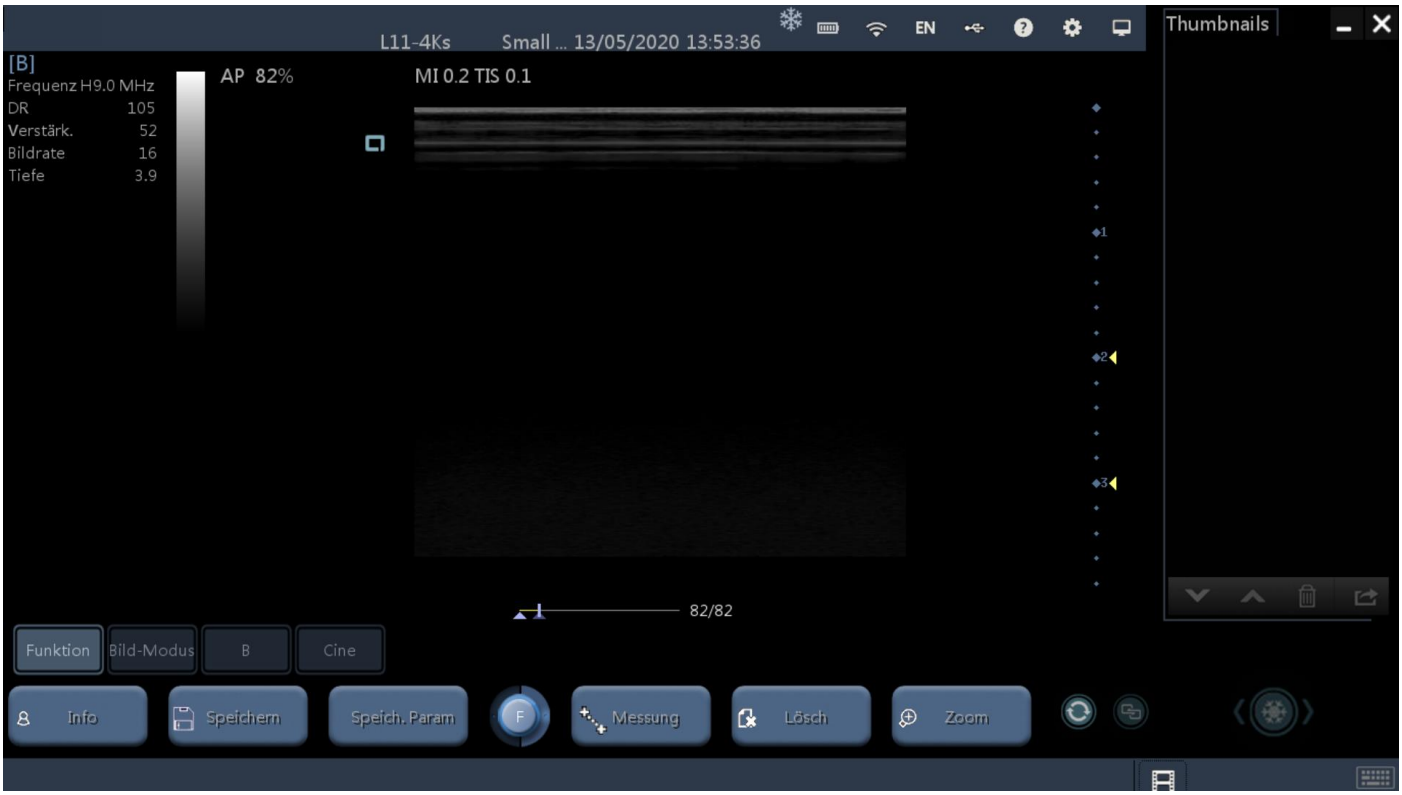
L11-4Ks
Small ... 13/05/2020 13:53:36
EN
Thumbnails
[B]
Frequenz H9.0 MHz
DR 105
Verstärk. 52
Bildrate 16
Tiefe 3.9
AP 82%
MI 0.2 TIS 0.1
82/82
Funktion
Bild-Modus
B
Cine
Info
Speichern
Speich. Param
F
Messung
Lösch
Zoom

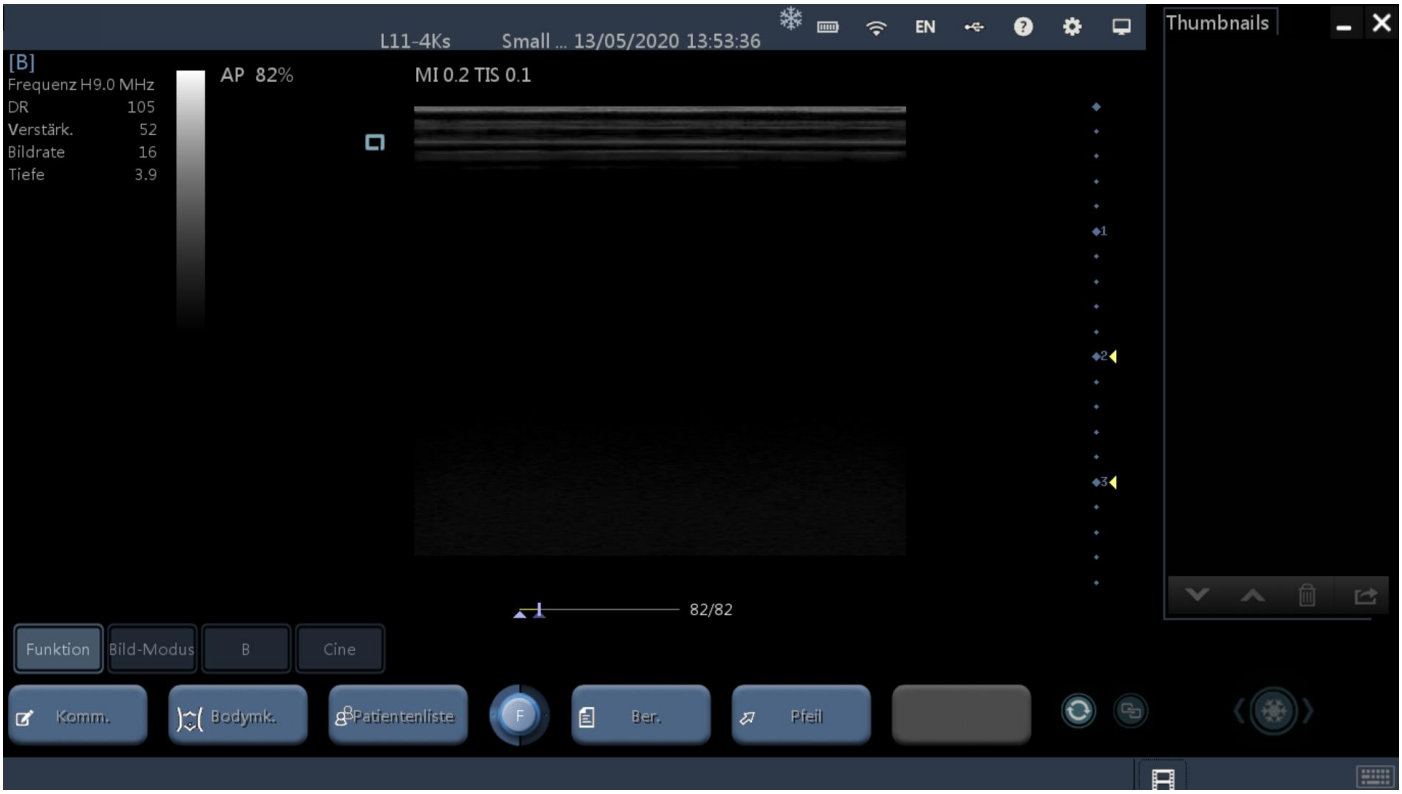
L11-4Ks
Small ... 13/05/2020 13:53:36
EN
Thumbnails
[B]
Frequenz H9.0 MHz
DR 105
Verstärk. 52
Bildrate 16
Tiefe 3.9
AP 82%
MI 0.2 TIS 0.1
82/82
Funktion
Bild-Modus
B
Cine
Komm.
Bodymk.
Patientenliste
F
Ber.
Pfeil

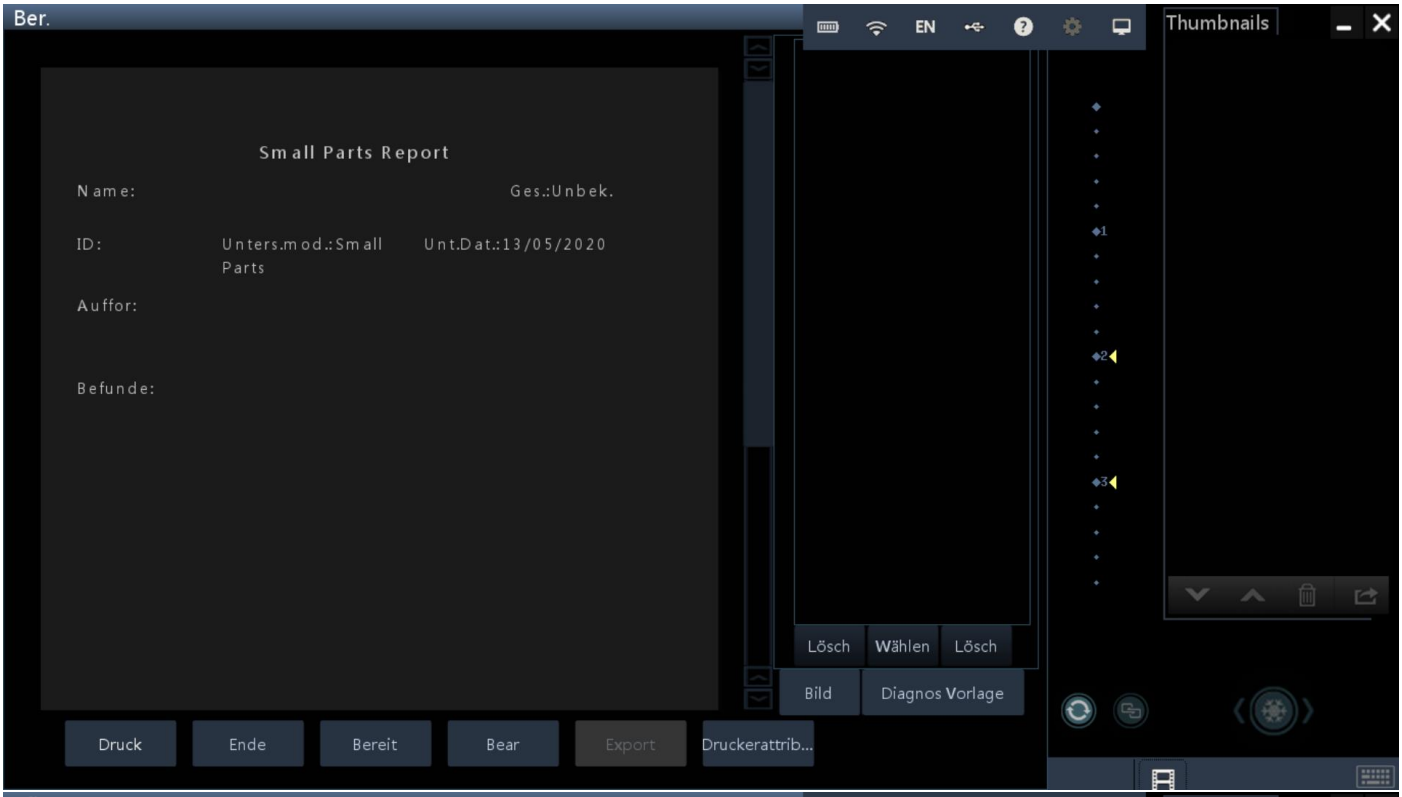
Ber.
EN
Thumbnails
Small Parts Report
Name:
Ges.:Unbek.
ID:
Unters.mod.:Small Parts
Unt.Dat.:13/05/2020
Auffor:
Befunde:
Lösch
Wählen
Lösch
Bild
Diagnos Vorlage
Druck
Ende
Bereit
Bear
Export
Druckerattrib...

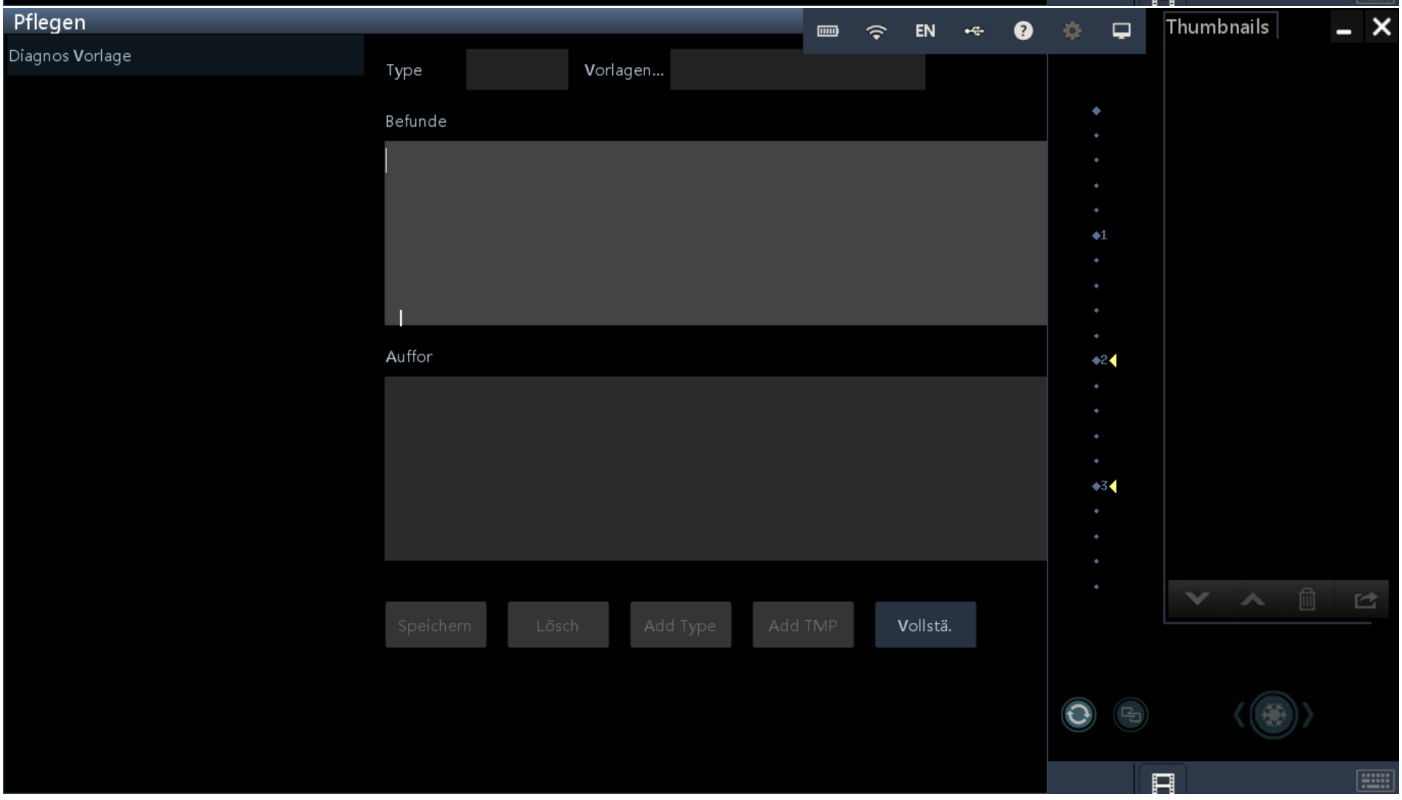
Pflegen
EN
Thumbnails
Diagnos Vorlage
Type
Vorlagen...
Befunde
Auffor
Speichern
Lösch
Add Type
Add TMP
Vollstä.